

**Информационная система управления ресурсами
медицинских организаций Тюменской области**

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Спецификации медицинских услуг

На 3 листах

г. Тюмень

2023 г.

Спецификации медицинских услуг

Для настройки необходимо перейти в подсистему «Нормативно-справочная информация» - раздел «Номенклатура» - «Номенклатура» (рис. 1).

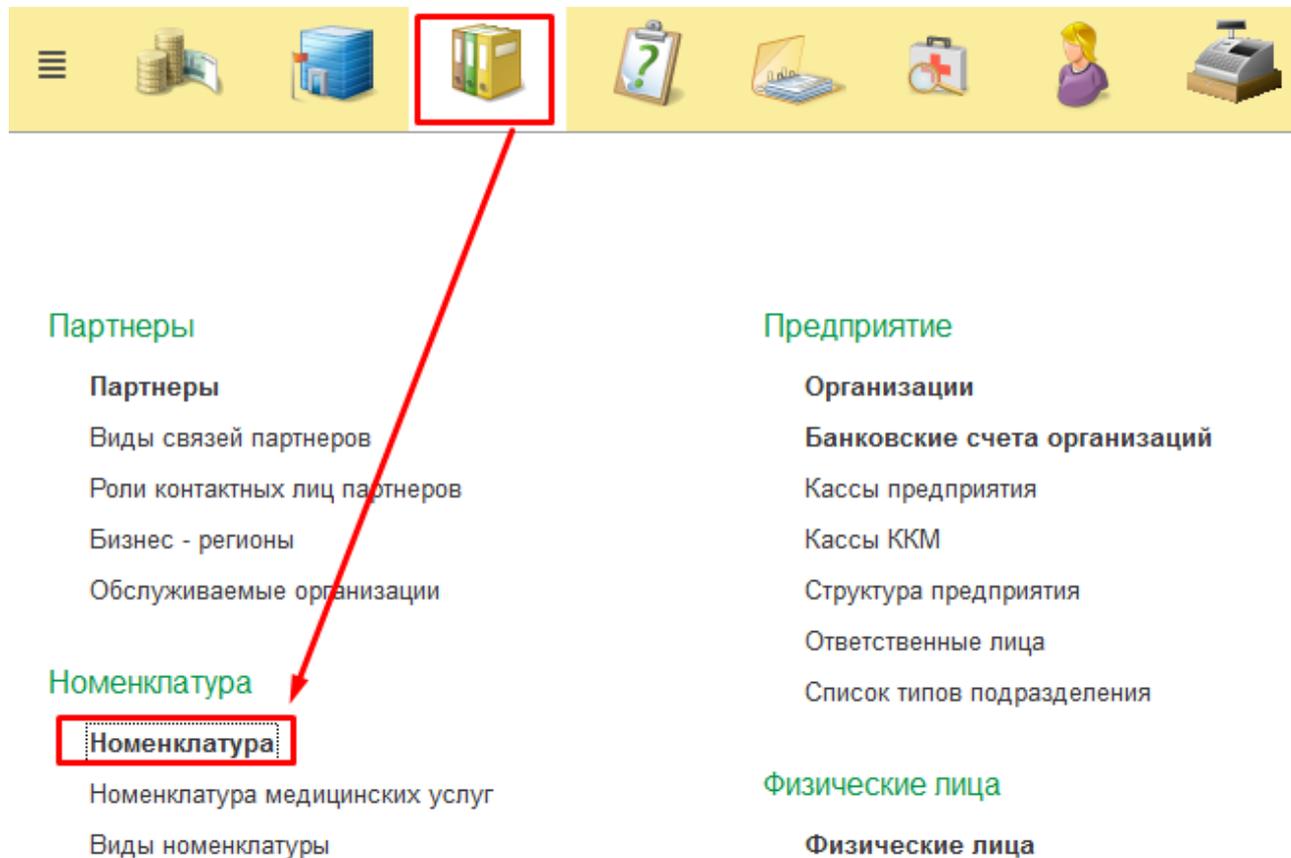


Рисунок 1 — Переход в раздел Номенклатура

Двойным нажатием перейти в нужную запись Номенклатуры и перейти по гиперссылке «Спецификации» (рис. 2).

☆ Аэрозольтерапия (Позиция номенклатуры) 🔗 ⋮ □ ×

Основное **Спецификации** Основные спецификации Данные по иммунопрофилактике Доступность услуги Загрузка ЛИС Еще...

Наименование:

Вид номенклатуры:

Единица хранения: Арт.:

Код минздрава: Версия классификатора минздрава:

Группа:

Наименование для печати:

Показания для выполнения услуги Противопоказания для выполнения услуги

Описание услуги

Подготовка: Не требует отметки исполнения:

Вид медицинской услуги: Профиль мед. помощи:

Исполнитель услуги:

Характер услуги: Тип консультации:

Информированное согласие: Отказ от вмешательства:

Идентификатор (сшп): Номер версии (сшп):

Рисунок 2 — Карточка Номенклатуры, переход по гиперссылке «Спецификация»

В спецификации услуг указывается, какие рабочие места могут выполнять выбранную услугу. Для создания новой спецификации услуги необходимо открыть ее, выбрать вкладку «Спецификации» и нажать кнопку «Создать» (рис. 3). Спецификацию создают в периферийной базе.

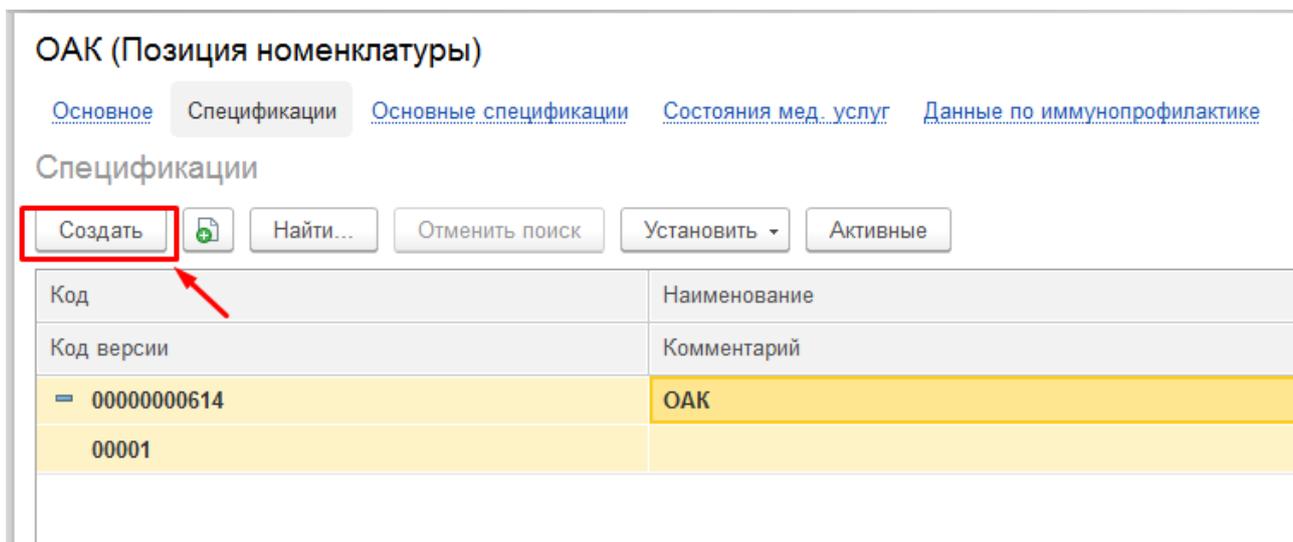


Рисунок 3 — Создание спецификации

Для указания рабочих мест, выполняющих выбранную услугу, необходимо открыть созданную для услуги спецификацию и в разделе «Места выполнения» добавить необходимые медицинские рабочие места из справочника «Медицинские рабочие места» (рис. 4).

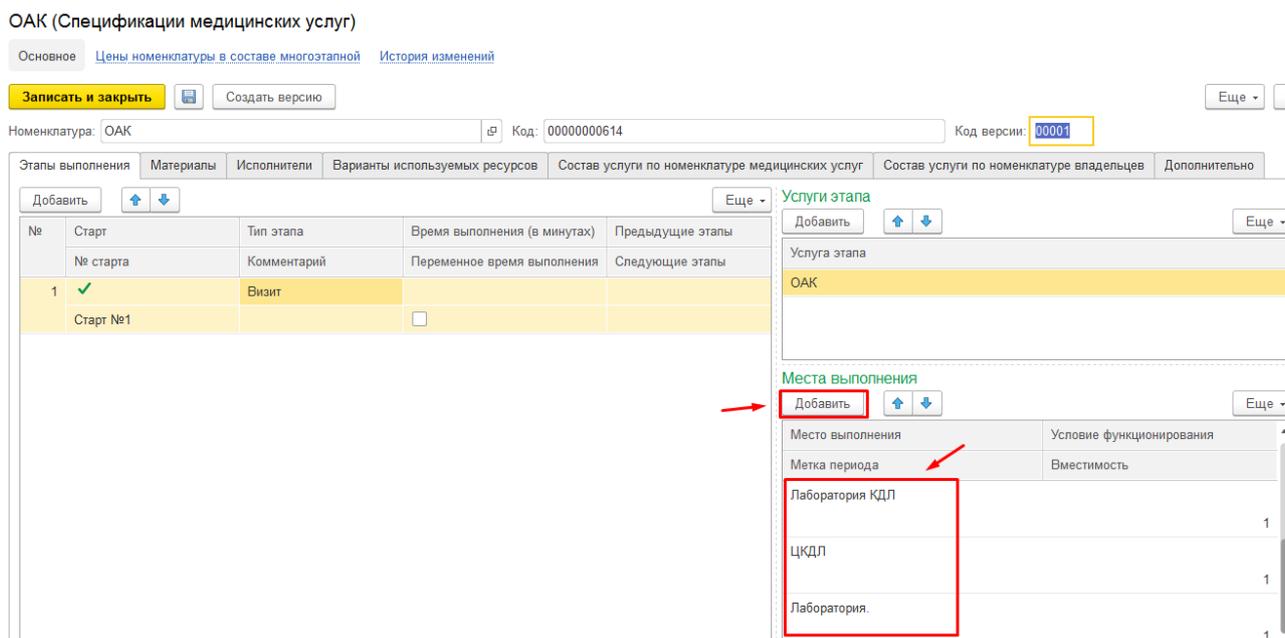


Рисунок 4 — Рабочие места спецификации медицинских услуг

Для сохранения введенных данных следует нажать кнопку «Записать и закрыть».

Далее нажать кнопку «Установить» и выбрать «Установить основную спецификацию на дату» (рис. 5), указать дату начала действия спецификации.

Активная спецификация должна отображаться в табличной форме жирным шрифтом. На этом настройка спецификации завершена.

ОАК (Позиция номенклатуры)

[Основное](#) [Спецификации](#) [Основные спецификации](#) [Состояния мед. услуг](#) [Данные по иммунопрофилактике](#) [Доступность услуги](#) [Загрузка ЛИС](#) [Запрет редактирования номенклатуры](#) [Еще...](#)

Спецификации

Создать  Найти... Отменить поиск **Установить** Активные Еще ?

Установить основную спецификацию на дату

Код	Комментарий	↑	Активная
Код версии			
00000000614	ОАК		✓
00001			

Рисунок 5 — Установление основной спецификации на дату